

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° D0495003-0712

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o n° 0442.

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Micrômetro Externo **Local da Calibração:** Laboratório da Metrus
Marca: CKJ **Modelo:** 1969 r
N° de Ativo: CQ-028 **N° de Série:** 8266
Faixa de Indicação: 25 - 50 mm **Valor de uma divisão:** 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 12/07/12

Calibração: 12/07/12

Emissão: 20/07/12

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N° MPC-0040 Revisão: 2

O micrômetro foi zerado no início da capacidade do instrumento. Os erros de medição do micrômetro foram verificados através da medição de blocos padrões nas dimensões estabelecidas, sendo efetuado a leitura diretamente no micrômetro. O paralelismo e a planicidade foram verificados diretamente com o jogo de paralelo óptico.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

N° Padrão	Descrição do Equipamento	N° do Relatório	Data de Validade
MTR-0243	Jogo de Paralelo Óptico	RBC, Mitutoyo 3334/08	04/2013
MTR-0255	Jogo de Blocos Padrão	RBC, Mitutoyo 12786/11	09/2016
MTR-0256	Jogo Blocos Padrão para Micrômetro	RBC, Mitutoyo 12615/09	11/2012

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

V.V.C	Valor médio das Indicações	Erro	K	U
mm	mm	mm		mm
25,000	25,000	0,000	2,00	0,001
27,500	27,501	0,001	2,00	0,001
30,100	30,102	0,002	2,00	0,001
32,700	32,700	0,000	2,00	0,001
35,300	35,302	0,002	2,00	0,001
37,900	37,902	0,002	2,00	0,001
40,000	40,000	0,000	2,00	0,001
42,600	42,601	0,001	2,00	0,001
45,200	45,201	0,001	2,00	0,001
47,800	47,802	0,002	2,00	0,001
50,000	50,001	0,001	2,00	0,001

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0495003-0712

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Planeza da Haste Móvel			Planeza da Haste Fixa		
Valor Encontrado	K	U	Valor Encontrado	K	U
mm		mm	mm		mm
0,00032	2,00	0,00026	0,00032	2,00	0,00026

Paralelismo entre hastes		
Valor Encontrado	K	U
mm		mm
0,00032	2,00	0,00033

Valores Máximos Obtidos:			
Parâmetros	Valores	K	U
	mm		mm
Erro	0,002	2,00	0,0012
Planeza	0,00032	2,00	0,00026
Paralelismo	0,00032	2,00	0,00033

6 - OBSERVAÇÕES:

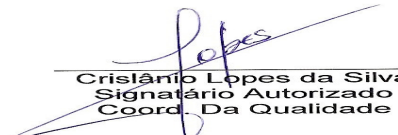
- Temperatura de referência: $20^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (entre $19,5^{\circ}\text{C}$ e $20,5^{\circ}\text{C}$), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Erro: Valor Médio da Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

/ FHS

FOR-0004 - Micrômetro Externo com Paralelo

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Diego Alves de Oliveira Antones


Crislânio Lopes da Silva
Signatário Autorizado
Coord. Da Qualidade