



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0090011-0512

1 - DADOS:

Ciente: DPaschoal - Comercial Automotiva Ltda.
Endereço: Av. Anton Von Zuben, 2155 - Jardim do Lago II - Campinas - SP.
Equipamento: Relógio Comparador **Marca:** Digimess
Nº de Ativo: SE8557D **Modelo:** 121.304
Nº de Série: 0A10452 **Local da Calibração:** Laboratório da Metrus
Faixa de Indicação: 0-10 mm **Valor de uma divisão:** 0,01 mm

2 - DATAS: **Recebimento:** 10/05/12 **Calibração:** 11/05/12 **Prox.cali:** 11/05/2018 **Emissão:** 15/05/2012

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0041 Revisão: 2

O relógio foi fixado no Tambor Micrométrico. O valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e lidos respectivamente no Padrão. Os Resultados da Calibração foram Obtidos deslocando-se o banco micrométrico no sentido de Entrada e Saída da Haste Móvel do Relógio.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0096	Tambor Micrométrico Digital	RBC, Feinmess D1236711	06/2013

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Valor Indicado no Mensurando	Correção	
	Entrada da Haste Móvel	Saída da Haste Móvel
mm	mm	mm
0,000	0,0000	-0,0010
0,100	0,0010	0,0000
0,200	0,0010	0,0000
0,300	0,0010	0,0000
0,400	0,0000	0,0000
0,500	0,0000	0,0000
0,600	0,0030	0,0040
0,700	0,0040	0,0050
0,800	0,0020	0,0030
0,900	0,0010	0,0000
1,000	-0,0010	-0,0010
1,500	-0,0010	-0,0010
2,000	-0,0030	-0,0020
2,500	0,0000	0,0020
3,000	0,0010	0,0010
3,500	0,0020	0,0020
4,000	0,0010	0,0010
4,500	0,0020	0,0020

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° D0090011-0512

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor Indicado no Mensurando	Correção	
	Entrada da Haste Móvel	Saída da Haste Móvel
5,000	0,0000	0,0000
6,000	-0,0020	-0,0010
7,000	-0,0030	-0,0020
8,000	-0,0010	0,0000
9,000	0,0020	0,0020
10,000	0,0020	0,0020

Parâmetros	Valores	K	U
	mm		mm
Correção	0,0050	2,00	0,0029
fe	0,0070	2,00	0,0029
fu	0,0020	2,00	0,0029
fges	0,0080	2,00	0,0029

- **fe:** O Desvio fe é a Distância de ordenadas entre o ponto mais elevado e o ponto mais profundo do transcorrer do desvio efetivo sobre o campo de indicação com o pino de medição executando um deslocamento para dentro.
- **fges:** O desvio total fges é a distância das ordenadas entre o ponto mais elevado e o ponto mais profundo do transcorrer do desvio efetivo sobre o campo de indicação nos deslocamentos para fora e para dentro do pino de medição
- **fu:** A faixa de Inversão do valor de Medição fu é a diferença nas indicações na mesma dimensão de comprimento nos movimentos para dentro e para fora do pino de medição em relação ao aparelho de medição (comparador).

6 - OBSERVAÇÕES:

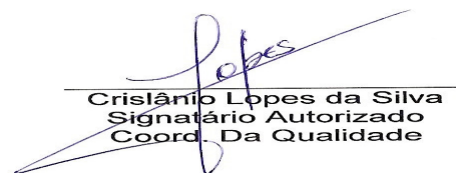
- Temperatura de referência: 20 °C ± 0,5°C (entre 19,5°C e 20,5°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Correção: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padrão combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Os resultados da Pré-Calibração são os mesmos da Calibração.

D0090011-0512 / CGS

FOR-0004 - Relógio Comparador

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Diego Alves de Oliveira Antonio


Crislânio Lopes da Silva
Signatário Autorizado
Coord. Da Qualidade