

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0234008-0815

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: White Metal Ind. e Comércio Ltda.
Endereço: Rua Miguel Martinês Lopes, N° 75 - Jardim Itatinga - Campinas - SP
Equipamento: Relógio Apalpador **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Nº de Ativo: RA-023 **Marca:** Insize
Nº de Série: OB16891 **Modelo:** Não Consta
Faixa de Indicação: 0 a 0,8 mm **Valor de uma divisão:** 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 31/08/2015

Calibração: 31/08/2015

Emissão: 01/09/2015

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0033 Revisão: 04


O Relógio Apalpador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio. O valor de referência é posicionado no Relógio Apalpador e o mesmo acionado nos dois sentidos, Avanço e Retorno, para as duas posições e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvios e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Apalpador.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0450	Calibrador de Relógio Comparador	RBC, Mitutoyo 07545/15	08/2018
MTR-0439	Termohigrômetro Digital	124034/15, ABSI, CAL nº 0056	05/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Posição 1		
Valor Indicado no Instrumento	Erro	
	Avanço	Retorno
mm	mm	mm
0,000	0,000	0,002
0,100	0,002	0,003
0,200	0,002	0,004
0,300	0,003	0,004
0,400	0,003	0,003
0,500	0,004	0,004
0,600	0,004	0,005
0,700	0,005	0,004
0,800	0,005	0,005

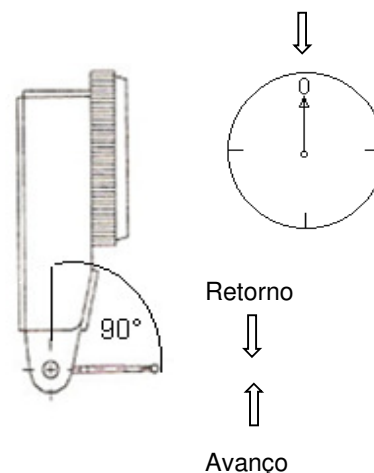

Parâmetros	Valores	K	veef	U
	mm			mm
fges	0,005	2,00	Infinito	0,002
fe	0,005			
fu	0,002			
fw	0,001			

- **fges:** O desvio fges é a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.

- **fe:** O Desvio fe é a amplitude dos erros no sentido de avanço.

- **fu:** Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto

- **fw:** Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média	K	U
mm	mm		mm
MEIO	0,001	2,01	0,002


Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média	K	U
mm	mm		mm
MEIO	0,001	2,01	0,002

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0234008-0815

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Posição 2		
Valor Indicado no Instrumento	Erro	
	Avanço	Retorno
mm	mm	mm
0,000	0,000	0,001
0,100	0,001	0,000
0,200	0,001	0,001
0,300	0,002	0,002
0,400	0,002	-0,001
0,500	0,003	0,002
0,600	0,003	0,002
0,700	0,004	0,003
0,800	0,004	0,003

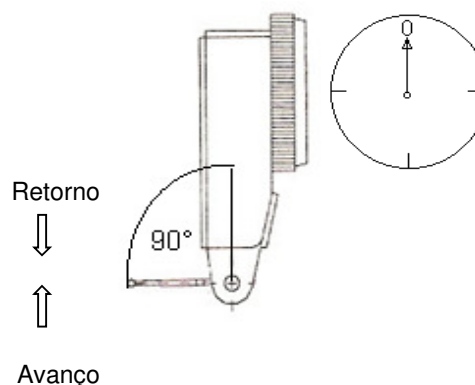

Parâmetros	Valores	K	veef	U
	mm			mm
fges	0,005	2,00	Infinito	0,002
fe	0,004			
fu	0,003			
fw	0,001			

- **fges**: O desvio fges é a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **fe**: O Desvio fe é a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **fu**: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **fw**: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média	K	U
	mm		mm
MEIO	0,001	2,01	0,002

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média	K	U
	mm		mm
MEIO	0,001	2,01	0,002

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C à 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nas instalações do cliente.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veef) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0234008-0815/ALA

FOR-0004 - Relógio Apalpador - REV.03 DATA: 22/06/2015

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado