

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP
Equipamento: Relógio Apalpador
Nº de Ativo: RA030
Nº de Série: Não Consta
Capacidade: 0 a 0,14 mm

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Marca: Mitutoyo
Modelo: 513-401
Resolução: 0,001 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 26/01/2024

Calibração: 05/02/2024

Emissão: 05/02/2024

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0033

Revisão: 06

O Relógio Apalpador foi fixado na mesa da Máquina de Medição Linear (SIP), e o valor de referência é posicionado no Relógio Apalpador e o mesmo acionado nos dois sentidos, de Avanço e Retorno, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do curso Relógio Apalpador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C


5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrometro Digital	E0178001-0222, Metrus, CAL 0442	02/2024
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	28779-22-DI/SP.1, Calibratec, CAL 0114	11/2024

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

Posição 1			
Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno	U
0,000	0,0000	0,0000	0,0005
0,010	0,0000	-0,0002	0,0005
0,020	0,0000	-0,0002	0,0005
0,030	0,0000	-0,0002	0,0005
0,040	0,0000	-0,0002	0,0005
0,050	0,0000	-0,0002	0,0005
0,060	0,0001	-0,0001	0,0005
0,070	0,0000	-0,0002	0,0005
0,080	-0,0001	-0,0003	0,0005
0,090	0,0000	-0,0002	0,0005
0,100	-0,0001	-0,0003	0,0005
0,110	0,0000	-0,0002	0,0005
0,120	-0,0001	-0,0003	0,0005
0,130	0,0000	-0,0002	0,0005
0,140	-0,0001	-0,0003	0,0005

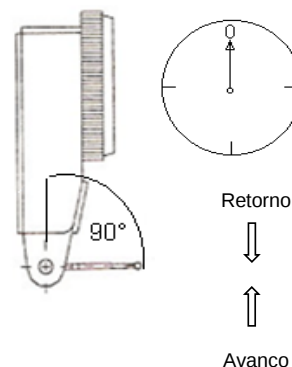

Parâmetros	Valores	K	Veff	U
fges	0,0004	2,00	Infinito	0,0008
fe	0,0002			
fu	0,0002			


Repetibilidade Avanço (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0003	2,00	0,0005

Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0001	2,00	0,0005

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Posição 2			
Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno	U
0,000	0,0000	0,0000	0,0005
0,010	0,0000	-0,0002	0,0005
0,020	0,0000	-0,0002	0,0005
0,030	0,0000	-0,0002	0,0005
0,040	0,0000	-0,0002	0,0005
0,050	0,0000	-0,0002	0,0005
0,060	0,0001	-0,0001	0,0005
0,070	0,0000	-0,0002	0,0005
0,080	-0,0001	-0,0008	0,0005
0,090	0,0000	-0,0005	0,0005
0,100	-0,0001	-0,0006	0,0005
0,110	0,0000	-0,0008	0,0005
0,120	-0,0005	-0,0008	0,0005
0,130	-0,0004	-0,0008	0,0005
0,140	-0,0005	-0,0008	0,0005

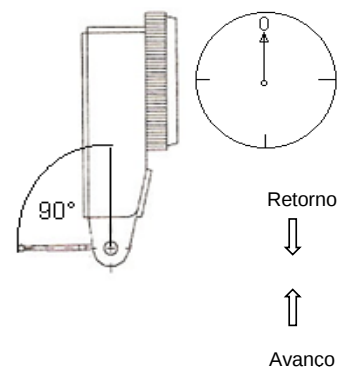

Parâmetros	Valores	K	Veff	U
fges	0,0009	2,00	Infinito	0,0008
fe	0,0006			
fu	0,0008			

Repetibilidade Avanço (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0001	2,00	0,0005

Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0002	2,00	0,0005

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

7 - OBSERVAÇÕES:


- Os valores dos erros informados nas tabelas da seção 6 representam as médias aritméticas de (03) três leituras efetuadas no indicador do padrão, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Padrão - Valor posicionado no Instrumento
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

HJ

FOR-0004-RAM - REV.13 - DATA: 01/07/2022

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Henrique Nunes Jacon


 Luís Fernando Vendramini
 Signatário Autorizado