

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201011-0920

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP

Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1

Nº de Ativo: CR153

Marca: Neomatic

Nº de Série: 54.732

Especificação da Rosca: 5 x 40 UNC - 2B

Modelo: Passa / Não Passa

2 - DATAS:

Recebimento: 10/09/2020

Calibração: 17/09/2020

Emissão: 17/09/2020

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089 Revisão: 06

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,5 °C

Umidade: 48 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	182104/20, ABSI, CAL nº 0056	02/2022
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33630-18-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2020
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	15237-19-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	05/2021
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	28794-200, Aferitec, CAL nº 0157	05/2022
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1509/18, Certi, CAL nº 0034	04/2021

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

	Diâmetro do Flanco (0°)				
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	2,767	0,001	2,00	Infinito	0,002
Altura B	2,768	0,002	2,00	Infinito	0,002

	Diâmetro do Flanco (90°)				
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	2,767	0,001	2,00	Infinito	0,002
Altura B	2,768	0,002	2,00	Infinito	0,002


	Passo (Altura Central)				
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
0°	0,636	0,001	2,00	Infinito	0,002
90°	0,637	0,002	2,00	Infinito	0,002

	Semi Ângulo (Altura Central 0°)				
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	4
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	4

	Semi Ângulo (Altura Central 90°)				
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	4
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	4

Especificações conforme a Norma ANSI / ASME B1.2		
Diâmetro Nominal	2,7661	mm
Diâmetro Mínimo	2,7636	mm
Diâmetro Máximo	2,7686	mm
Desgaste	--	mm
Passo	0,635	mm
Semi Ângulo	30° 0'	± 20'

The image shows a technical drawing of a screwdriver handle. The side view (top) shows a hexagonal handle with a textured grip at the top labeled 'N-ROSCA'. Dimensions A and B are indicated on the side view. The top view (bottom) shows the hexagonal cross-section with positions 1 and 2 marked.

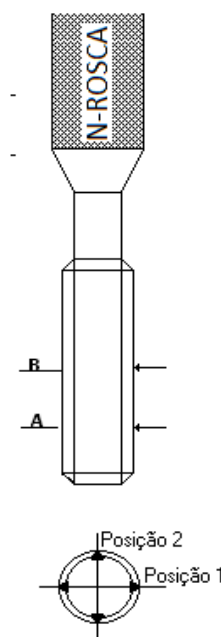

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201011-0920

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO


						Lado Não Passa			Especificações conforme a Norma ANSI / ASME B1.2		
						Diâmetro do Flanco (0°)					
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm				Diâmetro Nominal 2,8449 mm		
Altura A	2,846	0,001	2,00	Infinito	0,002				Diâmetro Mínimo 2,8423 mm		
Altura B	2,846	0,001	2,00	Infinito	0,002				Diâmetro Máximo 2,8474 mm		
									Desgaste -- mm		
									Passo 0,635 mm		
									Semi Ângulo 30° 0' ± 20'		

						Diâmetro do Flanco (90°)		
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm			
Altura A	2,845	0,000	2,00	Infinito	0,002			
Altura B	2,846	0,001	2,00	Infinito	0,002			

						Passo (Altura Central)		
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm			
0°	0,636	0,001	2,00	Infinito	0,002			
90°	0,635	0,000	2,00	Infinito	0,002			

						Semi Ângulo (Altura Central 0°)		
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')			
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	4			
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	4			

						Semi Ângulo (Altura Central 90°)		
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')			
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	4			
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	4			

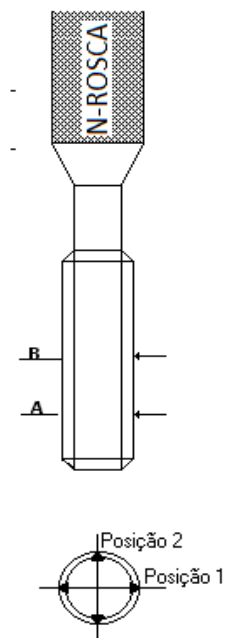

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

LFV

FOR-0004-CTRC - REV.10 - DATA 11/09/2020

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado