

### 1 - DADOS:

**Cliente:** ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP  
**Equipamento:** Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico **Local da Calibração:** Metrologia Dimensional 1  
**Nº de Ativo:** CR139 **Marca:** Insize  
**Nº de Série:** 0801130113 **Especificação da Rosca:** M 10 x 0,75 - 6H  
**Modelo:** Passa / Não Passa

### 2 - DATAS:

Recebimento: 19/04/2023      Calibração: 27/04/2023  
 Emissão: 27/04/2023

### 3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089

Revisão: 08

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

### 4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

### 5 - PADRÕES UTILIZADOS:


| Nº Padrão | Descrição do Equipamento        | Nº do Certificado                      | Data de Validade |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| MTR-0309  | Termohigrometro Digital         | E0178001-0222, Metrus, CAL 0442        | 02/2024          |
| MTR-0105  | Máquina de Medição Linear (SIP) | 28779-22-DI/SP.1, Calibratec, CAL 0114 | 11/2024          |
| MTR-0036  | Máquina de Medição Linear       | D4974-21, Feinmess, CAL 0133           | 05/2023          |
| MTR-0107  | Jogo de Arame                   | 34209-202, Aferitec, CAL 0157          | 05/2024          |
| MTR-0061  | Escala Angular                  | 1230/21, Certi, CAL 0034               | 04/2024          |

### 6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

| LADO PASSA                       |                          |          |      |          |        |
|----------------------------------|--------------------------|----------|------|----------|--------|
| Diâmetro do Flanco (0°)          |                          |          |      |          |        |
| Posição                          | Média das Medições       | Erro     | K    | Veff     | U      |
| Altura A                         | 9,5252                   | 0,0002   | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| Altura B                         | 9,5256                   | 0,0006   | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| Diâmetro do Flanco (90°)         |                          |          |      |          |        |
| Posição                          | Média das Medições       | Erro     | K    | Veff     | U      |
| Altura A                         | 9,5254                   | 0,0004   | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| Altura B                         | 9,5255                   | 0,0005   | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| Passo (Altura Central)           |                          |          |      |          |        |
| Posição                          | Média das Medições       | Erro     | K    | Veff     | U      |
| 0°                               | 0,7510                   | 0,0010   | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| 90°                              | 0,7509                   | 0,0009   | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| Semi Ângulo (Altura Central 0°)  |                          |          |      |          |        |
| Posição                          | Média das Medições (° ') | Erro (') | K    | Veff     | U (')  |
| LD                               | 30° 1'                   | 1        | 2,00 | Infinito | 4      |
| LE                               | 30° 2'                   | 2        | 2,00 | Infinito | 4      |
| Semi Ângulo (Altura Central 90°) |                          |          |      |          |        |
| Posição                          | Média das Medições (° ') | Erro (') | K    | Veff     | U (')  |
| LD                               | 30° 1'                   | 1        | 2,00 | Infinito | 4      |
| LE                               | 30° 0'                   | 0        | 2,00 | Infinito | 4      |


| Especificações conforme a Norma ISO R 1502 / DIN 13 |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Diâmetro Nominal                                    | 9,525 mm     |
| Diâmetro Mínimo                                     | 9,5195 mm    |
| Diâmetro Máximo                                     | 9,5305 mm    |
| Desgaste                                            | 9,5075 mm    |
| Passo                                               | 0,7500 mm    |
| Semi Ângulo                                         | 30° 0' ± 17' |

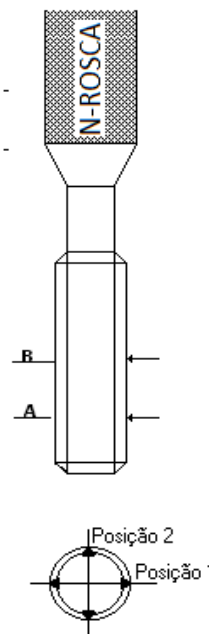

### CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

| LADO NÃO PASSA                   |                               |               |      |          |            |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------|----------|------------|
| Diâmetro do Flanco (0°)          |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 9,6488                        | -0,0017       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 9,6497                        | -0,0008       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Diâmetro do Flanco (90°)         |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 9,6489                        | -0,0016       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 9,6496                        | -0,0009       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Passo (Altura Central)           |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| 0°                               | 0,7505                        | 0,0005        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| 90°                              | 0,7507                        | 0,0007        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Semi Ângulo (Altura Central 0°)  |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 30° 0'                        | 0             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 30° 1'                        | 1             | 2,00 | Infinito | 4          |
| Semi Ângulo (Altura Central 90°) |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 30° 1'                        | 1             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |

| Especificações conforme a Norma<br>ISO R 1502 / DIN 13 |        |       |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| Diâmetro Nominal                                       | 9,6505 | mm    |
| Diâmetro Mínimo                                        | 9,645  | mm    |
| Diâmetro Máximo                                        | 9,656  | mm    |
| Desgaste                                               | 9,639  | mm    |
| Passo                                                  | 0,7500 | mm    |
| Semi Ângulo                                            | 30° 0' | ± 17' |

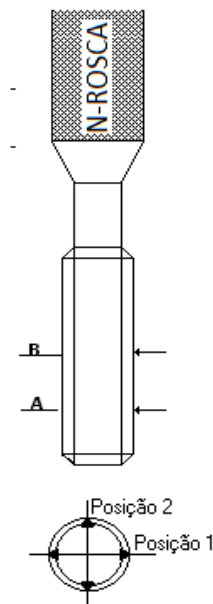

#### 7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada parâmetro medido, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Nominal de cada parâmetro
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MG

#### 8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Lucchesi Giroti

  
 Luís Fernando Vendramini  
 Signatário Autorizado

FOR-0004-CTRC - REV.13 - DATA 24/05/2022