

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

### 1 - DADOS:

**Ciente:** INBRASC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COMPONENTES LTDA  
**Endereço:** Rua Maranhão, N° 1716 - Bairro Capotuna - Jaguariúna - SP  
**Equipamento:** Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico  
**N° de Ativo:** CT-419  
**N° de Série:** 10110/1  
**Modelo:** Passa / Não Passa

**Local da Calibração:** Metrologia Dimensional

**Marca:** Ferriplax

**Especificação da Rosca:** 5/16" x 18 UNC - 2B

### 2 - DATAS:

Recebimento: 20/01/2026  
 Emissão: 23/01/2026

Calibração: 23/01/2026  
 Validade: 01/2027

### 3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°

**MPC-0089**

**Revisão: 10**

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

### 4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

### 5 - PADRÕES UTILIZADOS:


| N° Padrão | Descrição do Equipamento        | N° do Certificado                    | Data de Validade |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| MTR-0309  | Termo-higrômetro Digital        | E0178001-0224, Metrus, CAL 0442      | 02/2026          |
| MTR-0105  | Máquina de Medição Linear (SIP) | 32510-24-DI/SP, Calibratec, CAL 0114 | 11/2026          |
| MTR-0499  | Máquina de Medição Linear       | D04408/25, Feinmess, CAL 0133        | 05/2027          |
| MTR-0491  | Jogo de Arame                   | D0178029-0925, Metrus, CAL 0442      | 09/2027          |
| MTR-0061  | Escala Angular                  | 0773/24, Certi, CAL 0034             | 03/2027          |

### 6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

**Resultados Expresso em mm**

| LADO PASSA                       |                               |               |      |          |            |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------|----------|------------|
| Diâmetro do Flanco (0°)          |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 7,0231                        | -0,0013       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 7,0242                        | -0,0002       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Diâmetro do Flanco (90°)         |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 7,0236                        | -0,0008       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 7,0241                        | -0,0003       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Passo (Altura Central)           |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| 0°                               | 1,4141                        | 0,0030        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| 90°                              | 1,4144                        | 0,0033        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Semi Ângulo (Altura Central 0°)  |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| Semi Ângulo (Altura Central 90°) |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |

| Especificações conforme a Norma<br>ANSI / ASME B1.2 |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Diâmetro Nominal                                    | 7,0244 | mm    |
| Diâmetro Mínimo                                     | 7,0206 | mm    |
| Diâmetro Máximo                                     | 7,0282 | mm    |
| Desgaste                                            | --     | mm    |
| Passo                                               | 1,4111 | mm    |
| Semi Ângulo                                         | 30° 0' | ± 15' |

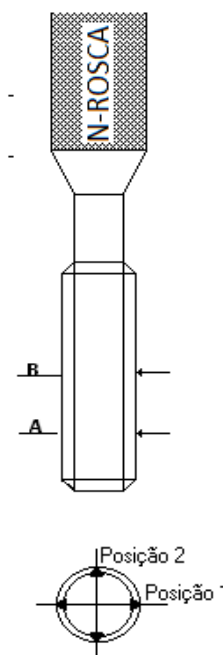

### CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

| LADO NÃO PASSA                   |                               |               |      |          |            |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------|----------|------------|
| Diâmetro do Flanco (0°)          |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 7,1482                        | -0,0032       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 7,1487                        | -0,0027       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Diâmetro do Flanco (90°)         |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 7,1491                        | -0,0023       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 7,1492                        | -0,0022       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Passo (Altura Central)           |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| 0°                               | 1,4131                        | 0,0020        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| 90°                              | 1,4122                        | 0,0011        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Semi Ângulo (Altura Central 0°)  |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| Semi Ângulo (Altura Central 90°) |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |

| Especificações conforme a Norma<br>ANSI / ASME B1.2 |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Diâmetro Nominal                                    | 7,1514 | mm    |
| Diâmetro Mínimo                                     | 7,1476 | mm    |
| Diâmetro Máximo                                     | 7,1552 | mm    |
| Desgaste                                            | --     | mm    |
| Passo                                               | 1,4111 | mm    |
| Semi Ângulo                                         | 30° 0' | ± 15' |



#### 7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada parâmetro medido, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Nominal de cada parâmetro
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MP

FOR-0004-CTRC - REV.15 - DATA 28/05/2025

#### 8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Celso Moreira de Paula

  
 Celso Moreira de Paula  
 Signatário Autorizado