

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

**1 - DADOS:**

**Cliente:** INBRASC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COMPONENTES LTDA  
**Endereço:** Rua Maranhão, N° 1716 - Bairro Capotuna - Jaguariúna - SP  
**Equipamento:** Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico  
**N° de Ativo:** CT 069  
**N° de Série:** 93.824  
**Modelo:** Passa / Não Passa

**Local da Calibração:** Metrologia Dimensional 2

**Marca:** Neomatic

**Especificação da Rosca:** G 1/8" x 28

**2 - DATAS:**

Recebimento: 09/10/2023

Emissão: 30/10/2023

Calibração: 30/10/2023

Validade: 10/2024

**3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°**

**MPC-0089**

**Revisão: 08**

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

**4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

**5 - PADRÕES UTILIZADOS:**

| N° Padrão | Descrição do Equipamento        | N° do Certificado                      | Data de Validade |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| MTR-0445  | Termohigrômetro Digital         | E0178001-0623, Metrus, CAL 0442        | 06/2025          |
| MTR-0105  | Máquina de Medição Linear (SIP) | 28779-22-DI/SP.1, Calibratec, CAL 0114 | 11/2024          |
| MTR-0499  | Máquina de Medição Linear       | D5842-23, Feinmess, CAL 0133           | 05/2025          |
| MTR-0491  | Jogo de Arame                   | D0178003-0923, Metrus, CAL 0442        | 09/2025          |
| MTR-0061  | Escala Angular                  | 1230/21, Certi, CAL 0034               | 04/2024          |

**6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:**

**Resultados Expresso em mm**

LADO PASSA

| Diâmetro do Flanco (0°) |                    |         |      |          |        |
|-------------------------|--------------------|---------|------|----------|--------|
| Posição                 | Média das Medições | Erro    | K    | Veff     | U      |
| Altura A                | 9,1463             | -0,0087 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| Altura B                | 9,1471             | -0,0079 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |

| Diâmetro do Flanco (90°) |                    |         |      |          |        |
|--------------------------|--------------------|---------|------|----------|--------|
| Posição                  | Média das Medições | Erro    | K    | Veff     | U      |
| Altura A                 | 9,1475             | -0,0075 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| Altura B                 | 9,1477             | -0,0073 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |


| Passo (Altura Central) |                    |        |      |          |        |
|------------------------|--------------------|--------|------|----------|--------|
| Posição                | Média das Medições | Erro   | K    | Veff     | U      |
| 0°                     | 0,9081             | 0,0010 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| 90°                    | 0,9086             | 0,0015 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |

| Semi Ângulo (Altura Central 0°) |                          |          |      |          |       |
|---------------------------------|--------------------------|----------|------|----------|-------|
| Posição                         | Média das Medições (° ') | Erro (') | K    | Veff     | U (') |
| LD                              | 27° 32'                  | 2        | 2,00 | Infinito | 4     |
| LE                              | 27° 33'                  | 3        | 2,00 | Infinito | 4     |

| Semi Ângulo (Altura Central 90°) |                          |          |      |          |       |
|----------------------------------|--------------------------|----------|------|----------|-------|
| Posição                          | Média das Medições (° ') | Erro (') | K    | Veff     | U (') |
| LD                               | 27° 31'                  | 1        | 2,00 | Infinito | 4     |
| LE                               | 27° 32'                  | 2        | 2,00 | Infinito | 4     |

Especificações conforme a Norma  
DIN ISO 228

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Diâmetro Nominal | 9,155   | mm    |
| Diâmetro Mínimo  | 9,15    | mm    |
| Diâmetro Máximo  | 9,16    | mm    |
| Desgaste         | 9,141   | mm    |
| Passo            | 0,9071  | mm    |
| Semi Ângulo      | 27° 30' | ± 15' |

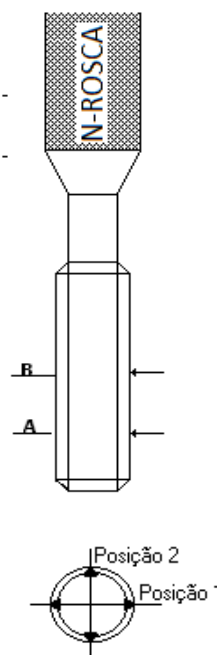

### CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

| LADO NÃO PASSA                   |                               |               |      |          |            |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------|----------|------------|
| Diâmetro do Flanco (0°)          |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 9,2544                        | -0,0046       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 9,2550                        | -0,0040       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Diâmetro do Flanco (90°)         |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 9,2555                        | -0,0035       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 9,2557                        | -0,0033       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Passo (Altura Central)           |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| 0°                               | 0,9084                        | 0,0013        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| 90°                              | 0,9089                        | 0,0018        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Semi Ângulo (Altura Central 0°)  |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 27° 31'                       | 1             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 27° 32'                       | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| Semi Ângulo (Altura Central 90°) |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 27° 32'                       | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 27° 32'                       | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |

| Especificações conforme a Norma<br>DIN ISO 228 |         |       |
|------------------------------------------------|---------|-------|
| Diâmetro Nominal                               | 9,259   | mm    |
| Diâmetro Mínimo                                | 9,254   | mm    |
| Diâmetro Máximo                                | 9,264   | mm    |
| Desgaste                                       | 9,249   | mm    |
| Passo                                          | 0,9071  | mm    |
| Semi Ângulo                                    | 27° 30' | ± 16' |



#### 7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada parâmetro medido, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Nominal de cada parâmetro
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

LFV

#### 8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini



Luís Fernando Vendramini  
Signatário Autorizado

FOR-0004-CTRC - REV.13 - DATA 24/05/2022