

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800010-0518

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
 Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilindrico
 Nº de Ativo: CTR113
 Nº de Série: Não Consta
 Modelo: P/NP

Local da Calibração: Metrologia Dimensional (1)
 Marca: Kingtools
 Especificação da Rosca: M 16 x 1,5 - 6H

2 - DATAS:

Recebimento: 02/05/2018

Calibração: 02/05/2018

Emissão: 10/05/2018

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089

Revisão: 06

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semi-ângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	03388/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	05/2020
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	28363-105, Aferitec, CAL nº 0157	05/2018
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714-15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1509/18, Certi, CAL nº 0034	04/2021
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	156556/18, ABSI, CAL nº 0056	02/2020

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:



Lado Passa						Especificação		
Diâmetro do Flanco (0°)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	mm	mm			mm			
Altura A	15,039	0,001	2,00	Infinito	0,002	Diâmetro Nominal	15,038	mm
Altura B	15,039	0,001	2,00	Infinito	0,002	Diâmetro Mínimo	15,015	mm
						Diâmetro Maximo	15,049	mm
						Desgaste	0	mm
						Passo	1,500	mm
						Semi Ângulo	30° 0'	

Diâmetro do Flanco (90°)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	mm	mm			mm			
Altura A	15,039	0,001	2,00	Infinito	0,002			
Altura B	15,038	0,000	2,00	Infinito	0,002			

Passo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	mm	mm			mm			
0°	1,501	0,001	2,08	32	0,002			
90°	1,501	0,001	2,08	32	0,002			

Semi Ângulo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	(° ')	(')			(')			
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2			
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2			

Semi Ângulo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	(° ')	(')			(')			
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2			
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	2			

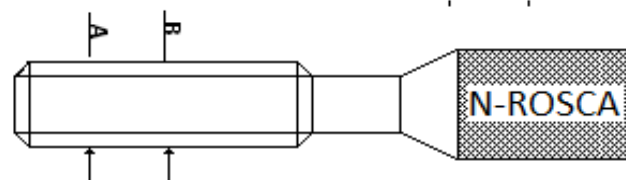

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800010-0518

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

Lado Não Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					Especificação
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
mm	mm			mm	
Altura A	15,224	0,002	2,00	Infinito	0,002
Altura B	15,225	0,003	2,00	Infinito	0,002

Diâmetro do Flanco (90°)					Especificação
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
mm	mm			mm	
Altura A	15,223	0,002	2,00	Infinito	0,002
Altura B	15,225	0,003	2,00	Infinito	0,002

Passo (Altura Central)					Especificação
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
				mm	
0°	1,501	0,001	2,08	32	0,002
90°	1,501	0,001	2,08	32	0,002

Semi Ângulo (Altura Central)					Especificação
0°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	2

Semi Ângulo (Altura Central)					Especificação
90°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2

Diâmetro do Flanco (0°)			Especificação		
Diâmetro Nominal	15,2215	mm	Diâmetro Mínimo	15,2045	mm
Diâmetro Máximo	15,2325	mm	Desgaste	--	mm
Passo	1,500	mm	Semi Ângulo	30° 0'	

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos Laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na apresentação do valor encontrado expressa é a média de três medições
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0800010-0518/BMM

FOR-0004-CTRC - REV.06 - DATA 07/08/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Maria Eduarda Gomes da Silva


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado