

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800029-1017

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
 Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilindrico
 Nº de Ativo: CTR 114
 Nº de Série: Não consta
 Modelo: P/NP

Local da Calibração: Metrologia Dimensional (1)
 Marca: King Tools
 Especificação da Rosca: 8 x 32 UNC 2B

2 - DATAS:

Recebimento: 17/10/2017

Calibração: 17/10/2017

Emissão: 24/10/2017

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089 Revisão: 06

O Calibrador Tampão Roscado Cilindrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semi-ângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	03388/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	05/2020
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	28363-105, Aferitec, CAL nº 0157	05/2018
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714-15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1227/15, Certi, CAL nº 0034	04/2018
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	133376/16, ABSI, CAL nº 0056	03/2018

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

	Lado Passa				
	Diâmetro do Flanco (0°)				
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	mm	mm			mm
Altura A	3,641	-0,013	2,01	Infinito	0,002
Altura B	3,641	-0,013	2,01	Infinito	0,002

	Diâmetro do Flanco (90°)				
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	mm	mm			mm
Altura A	3,641	-0,013	2,01	Infinito	0,002
Altura B	3,641	-0,013	2,01	Infinito	0,002

	Passo (Altura Central)				
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	mm	mm			mm
0°	0,794	0,000	2,08	32	0,002
90°	0,794	0,000	2,08	33	0,002



	Semi Ângulo (Altura Central)				
0°	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	(° ')	(')			(')
LD	30° 3'	3	2,03	76,00	2
LE	30° 4'	4	2,03	76,00	2

	Semi Ângulo (Altura Central)				
90°	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	(° ')	(')			(')
LD	30° 2'	2	2,03	76,00	2
LE	30° 4'	4	2,03	76,00	2

Especificação		
Diâmetro Nominal	3,654	mm
Diâmetro Mínimo	3,65	mm
Diâmetro Máximo	3,658	mm
Desgaste	--	mm
Passo	0,794	mm
Semi Ângulo	30° 0'	

A technical drawing of a screw thread. It shows a cylindrical part with a thread. Two vertical arrows, labeled A and B, point to the top and bottom of the thread. The thread is labeled N-ROSA.

A technical drawing of a circular cross-section. It shows a circle with a crosshair. Two points are marked on the circle, labeled Posição 1 and Posição 2.

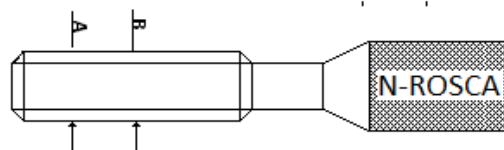

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800029-1017


Lado Não Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					Especificação
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
mm	mm			mm	
Altura A	3,730	-0,013	2,01	Infinito	0,002

Diâmetro do Flanco (90°)					
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
mm	mm			mm	
Altura A	3,730	-0,013	2,01	Infinito	0,002

Passo (Altura Central)					
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
				mm	
0°	0,794	0,000	2,08	32	0,002
90°	0,793	-0,001	2,08	32	0,002

Semi Ângulo (Altura Central)					
0°	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	(° ')	(')			(')
LD	30° 3'	3	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,03	76,00	2

Semi Ângulo (Altura Central)					
90°	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
	(° ')	(')			(')
LD	30° 4'	4	2,03	76,00	2
LE	30° 3'	3	2,00	Infinito	2

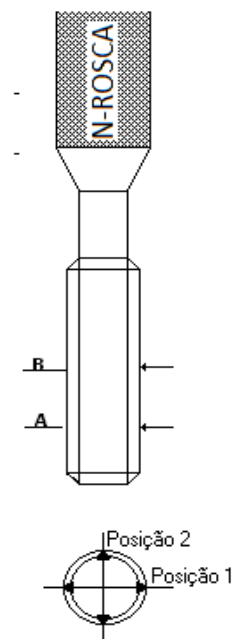

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos Laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na apresentação do valor encontrado expressa é a média de três medições
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0800029-1017/ACSA

FOR-0004-CTRC - REV.06 - DATA 07/08/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari

Página 2 de 2


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado