

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800040-1018

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
 Equipamento: Relógio Apalpador Local da Calibração: Instalações do Cliente
 Nº de Ativo: REA 018 Marca: Mitutoyo
 Nº de Série: LDR027 Modelo: 513-415
 Faixa de Indicação: 0 a 1 mm Valor de uma divisão: 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 16/10/2018 Calibração: 16/10/2018
 Emissão: 17/10/2018

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0033 Revisão: 04

O Relógio Apalpador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio. O valor de referência é posicionado no Relógio Apalpador e o mesmo acionado nos dois sentidos, Avanço e Retorno, para as duas posições e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Apalpador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,6 °C


Umidade: 49 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0360	Termohigrômetro Digital	144280/17, ABSI, CAL nº 0056	02/2019
MTR-0450	Calibrador de Relógio Comparador	05495/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	08/2019

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Posição 1		
Valor Indicado no Instrumento mm	Erro do Avanço mm	Erro do Retorno mm
0,000	0,000	-0,001
0,100	-0,001	0,000
0,200	-0,002	-0,001
0,300	-0,003	-0,002
0,400	-0,003	-0,002
0,500	-0,003	-0,002
0,600	-0,003	-0,002
0,700	-0,004	-0,003
0,800	-0,003	-0,002
0,900	-0,003	-0,003
1,000	-0,003	-0,002

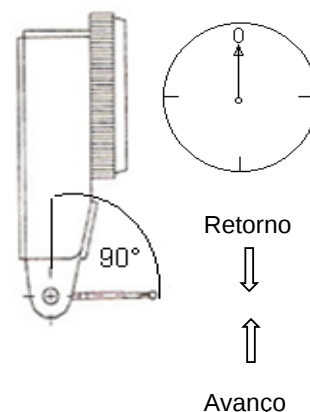

Parâmetros	Valores mm	K	V _{eff}	U mm
f _{ges}	0,004	2,03	83	0,002
f _e	0,004			
f _u	0,001			
f _w	0,001			

- **f_{ges}**: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **f_e**: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **f_u**: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **f_w**: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800040-1018

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO


Posição 2		
Valor Indicado no Instrumento mm	Erro do Avanço mm	Erro do Retorno mm
0,000	0,000	0,000
0,100	-0,002	-0,002
0,200	-0,002	-0,001
0,300	-0,002	-0,002
0,400	-0,003	-0,003
0,500	-0,002	-0,002
0,600	-0,002	-0,002
0,700	-0,002	-0,001
0,800	-0,003	-0,003
0,900	-0,003	-0,003
1,000	-0,003	-0,003

Parâmetros	Valores mm	K	V _{eff}	U mm
f _{ges}	0,003	2,03	83	0,002
f _e	0,003			
f _u	0,001			
f _w	0,001			

- **f_{ges}**: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **f_e**: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **f_u**: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **f_w**: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,000	2,00	0,002

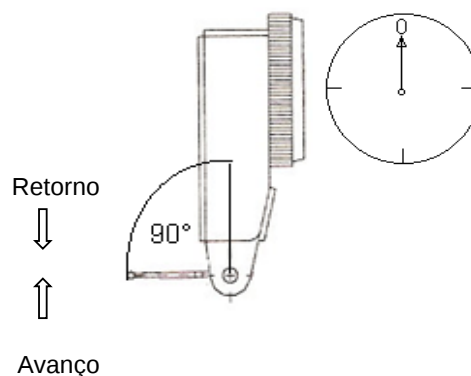

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veef) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0800040-1018/MHP

FOR-0004-RAC - REV.08 - DATA: 04/09/2018

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado