

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800075-1118

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico
Nº de Ativo: CTR074
Nº de Série: 18/07/08
Modelo: Passa / Não Passa

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Marca: Neomatic
Especificação da Rosca: M 3 x 0,5 - 6G

2 - DATAS:

Recebimento: 14/11/2018

Calibração: 14/11/2018

Emissão: 14/11/2018

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089

Revisão: 06

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,3 °C

Umidade: 48 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	156556/18, ABSI, CAL nº 0056	02/2020
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714-15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	03388/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	05/2019
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	25899-108, Aferitec, CAL nº 0157	05/2020
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1509/18, Certi, CAL nº 0034	04/2021

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Lado Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	2,704	0,003	2,00	Infinito	0,002
Altura B	2,704	0,003	2,00	Infinito	0,002

Especificação		
Diâmetro Nominal	2,701	mm
Diâmetro Mínimo	2,683	mm
Diâmetro Máximo	2,711	mm
Desgaste	--	mm
Passo	0,500	mm
Semi Ângulo	30° 0'	

Diâmetro do Flanco (90°)					
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	2,704	0,003	2,00	Infinito	0,002
Altura B	2,704	0,003	2,00	Infinito	0,002

Passo (Altura Central)					
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
0°	0,501	0,001	2,00	Infinito	0,002
90°	0,501	0,001	2,00	Infinito	0,002

Semi Ângulo (Altura Central)					
0°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,05	53	2

Semi Ângulo (Altura Central)					
90°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800075-1118

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

Lado Não Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					Especificação
Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm	
Altura A	2,799	-0,001	2,00	Infinito	0,002
Altura B	2,799	-0,001	2,00	Infinito	0,002


Diâmetro do Flanco (90°)					
Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm	
Altura A	2,799	-0,001	2,00	Infinito	0,002
Altura B	2,799	-0,001	2,00	Infinito	0,002

Passo (Altura Central)					
Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm	
0°	0,501	0,001	2,00	Infinito	0,002
90°	0,501	0,001	2,00	Infinito	0,002

Semi Ângulo (Altura Central)					
0°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,05	53	2

Semi Ângulo (Altura Central)					
90°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2

Diâmetro Nominal			2,7995	mm
Diâmetro Mínimo			2,7845	mm
Diâmetro Máximo			2,7885	mm
Desgaste			--	mm
Passo			0,500	mm
Semi Ângulo			30° 0'	

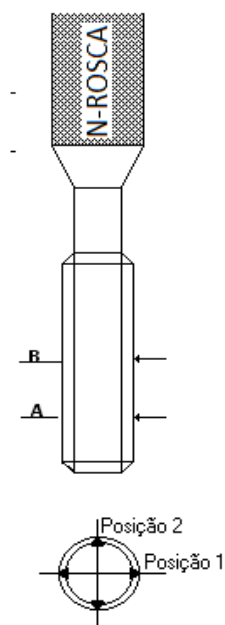

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0800075-1118/MHP

FOR-0004-CTRC - REV.07 - DATA 16/10/2018

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado