

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501017-0319

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: RODOVIA ABRÃO ASSED. KM 53+450 M - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRÃO PRETO - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico
Nº de Ativo: 5100576
Nº de Série: Não consta
Modelo: Passa / Não Passa

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Marca: Einst
Especificação da Rosca: M 14 x 1,0 - 6H

2 - DATAS:

Recebimento: 22/03/2019

Calibração: 22/03/2019

Emissão: 22/03/2019

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089

Revisão: 06

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,5 °C



Umidade: 48 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	156556/18, ABSI, CAL nº 0056	02/2020
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33630-18-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2020
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	03388/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	05/2019
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	25899-108, Aferitec, CAL nº 0157	05/2020
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1509/18, Certi, CAL nº 0034	04/2021

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Lado Passa						Especificação		
Diâmetro do Flanco (0°)						Diâmetro Nominal	13,362	mm
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Diâmetro Mínimo	13,3565	mm
	mm	mm			mm	Diâmetro Máximo	13,3675	mm
Altura A	13,361	-0,001	2,00	Infinito	0,002	Desgaste	13,3445	mm
Altura B	13,362	0,000	2,00	Infinito	0,002	Passo	1,000	mm
						Semi Ângulo	30° 0'	
Diâmetro do Flanco (90°)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	mm	mm			mm			
Altura A	13,361	-0,001	2,00	Infinito	0,002			
Altura B	13,361	-0,001	2,00	Infinito	0,002			
Passo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	mm	mm			mm			
0°	1,003	0,003	2,00	Infinito	0,002			
90°	1,002	0,002	2,00	Infinito	0,002			
Semi Ângulo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	(° ')	(')			(')			
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2			
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2			
Semi Ângulo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	(° ')	(')			(')			
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2			
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	2			

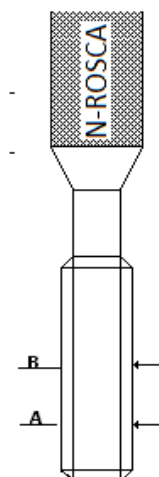

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501017-0319

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442


Lado Não Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					Especificação
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	13,517	0,002	2,00	Infinito	0,002
Altura B	13,518	0,003	2,00	Infinito	0,002

Diâmetro do Flanco (90°)					
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	13,518	0,003	2,00	Infinito	0,002
Altura B	13,518	0,003	2,00	Infinito	0,002

Passo (Altura Central)					
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
0°	1,002	0,002	2,00	Infinito	0,002
90°	1,002	0,002	2,00	Infinito	0,002

Semi Ângulo (Altura Central)					
	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
0°	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2

Semi Ângulo (Altura Central)					
	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
90°	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	2

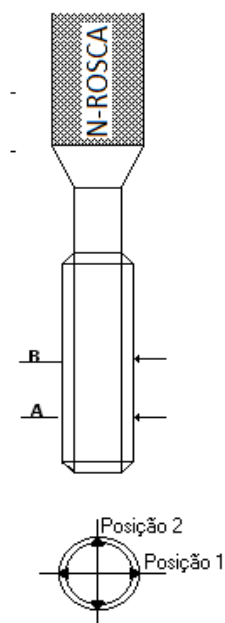

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0501017-0319/LFV

FOR-0004-CTRC - REV.08 - DATA 19/03/2019

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado