

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501029-0118

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
 Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
 Equipamento: Relógio Apalpador Local da Calibração: Instalações do Cliente
 Nº de Ativo: 5002856 Marca: Mitutoyo
 Nº de Série: VBY078 Modelo: 513-404
 Faixa de Indicação: 0 a 0,8 mm Valor de uma divisão: 0,01 mm

2 - DATAS: Recebimento: 24/01/2018 Calibração: 24/01/2018 Emissão: 26/01/2018

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0033 Revisão: 04


O Relógio Apalpador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio. O valor de referência é posicionado no Relógio Apalpador e o mesmo acionado nos dois sentidos, Avanço e Retorno, para as duas posições e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Apalpador.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0450	Calibrador de Relógio Comparador	07545/15, Mitutoyo, CAL nº 0031	08/2018
MTR-0360	Termohigrômetro Digital	144280/17, ABSI, CAL nº 0056	02/2019

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Posição 1		
Valor Indicado no Instrumento	Desvio	
	Avanço	Retorno
mm	mm	mm
0,000	0,000	0,001
0,100	0,001	0,002
0,200	0,000	-0,001
0,300	0,000	-0,001
0,400	0,000	0,000
0,500	-0,001	0,000
0,600	-0,001	0,000
0,700	-0,001	-0,001
0,800	-0,001	0,001

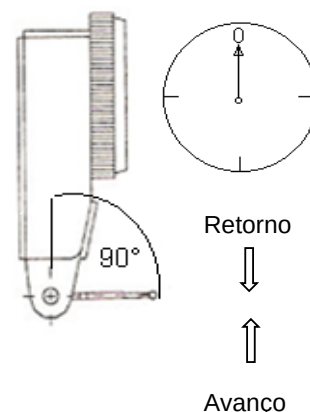

Parâmetros	Valores	K	Veff	U
	mm			mm
fges	0,003	2,00	Infinito	0,002
fe	0,002			
fu	0,002			
fw	0,000			

- **fges:** É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **fe:** É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **fu:** Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **fw:** Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média	K	U
	mm		mm
MEIO	0,000	2,00	0,002


Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média	K	U
	mm		mm
MEIO	0,000	2,00	0,002

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0501029-0118

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Posição 2		
Valor Indicado no Instrumento	Desvio	
	Avanço	Retorno
mm	mm	mm
0,000	0,000	0,001
0,100	0,001	0,001
0,200	0,002	0,001
0,300	0,002	0,002
0,400	0,003	0,002
0,500	0,002	0,001
0,600	0,002	0,003
0,700	0,002	0,003
0,800	0,003	0,002

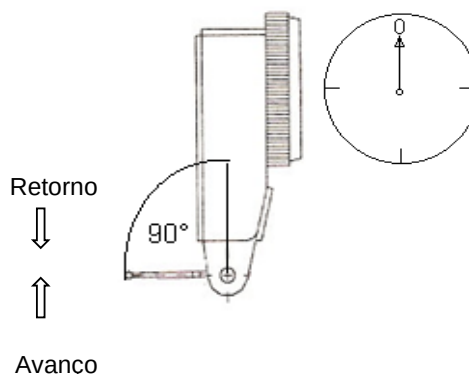

Parâmetros	Valores mm	K	Veff	U mm
fges	0,003	2,00	Infinito	0,002
fe	0,003			
fu	0,001			
fw	0,001			

- **fges**: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **fe**: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **fu**: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **fw**: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C à 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nas instalações do cliente.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Desvio: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0501029-0118/BMM

FOR-0004-RAC - REV.07 - DATA: 13/09/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Gustavo Lopes Soares

Página 2 de 2

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado

CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO - EPP

Rua José Veríssimo da Silva, 305 - Jd. Santana Parolli - Limeira - SP. Fone: (19) 3441-5280 - contato@metruscalibacao.com.br