

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: BIOMECÂNICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
Endereço: Rua Luiz Pengo, N° 145 - 1° Distrito Industrial - Jaú - SP
Equipamento: Calibrador Anel Roscado Cilíndrico
N° de Ativo: GAB-1302C
N° de Série: HZ24080008
Modelo: Não Passa

Local da Calibração: Metrologia Dimensional
Marca: Asimeto
Especificação da Rosca: M 40 x 3,0 - 6g

2 - DATAS:

Recebimento: 17/10/2025
Emissão: 29/10/2025

Calibração: 29/10/2025

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°

MPC-0129

Revisão: 10

O Calibrador Anel Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro e seu passo foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de Apalpadores Esféricos Calibrados. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

N° Padrão	Descrição do Equipamento	N° do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0224, Metrus, CAL 0442	02/2026
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	32510-24-DI/SP, Calibratec, CAL 0114	11/2026
MTR-0055	Coleção de Apalpadores Esféricos	2276/24, Certi, CAL 0034	07/2026
MTR-0056	Coleção de Apalpadores Esféricos	2277/24, Certi, CAL 0034	07/2026
MTR-0053	Relógio Comparador Balanceado	D0178001-1123, Metrus, CAL 0442	11/2025
MTR-0060	Padrão de Diâmetro Primitivo 60°	0772/24, Certi, CAL 0034	03/2027

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

RESULTADOS EXPRESSO EM mm

Não Passa

Diâmetro do Flanco (0°)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura A	37,799	0,005	2,00	Infinito	0,004

Altura B	37,798	0,004	2,00	Infinito	0,004
----------	--------	-------	------	----------	-------


Diâmetro do Flanco (90°)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura A	37,802	0,008	2,00	Infinito	0,004

Altura B	37,798	0,004	2,00	Infinito	0,004
----------	--------	-------	------	----------	-------

Passo (Altura Central)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
0°	3,002	0,002	2,00	Infinito	0,003
90°	3,002	0,002	2,00	Infinito	0,003

Critério de Aceitação	0,024 mm
Erro + 1m (máximos)	0,012 mm
Status	Aprovado

Especificações conforme a Norma ISO R 1502 / DIN 13		
Diâmetro Nominal:	37,794	mm
Diâmetro Mínimo:	37,785	mm
Diâmetro Máximo:	37,803	mm
Desgaste:	37,809	mm
Passo:	3,000	mm

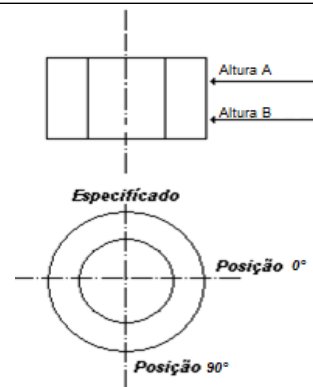

7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada diâmetro, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.

- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Nominal de cada parâmetro

- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.

- É proibida a reprodução parcial deste documento.

- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

- Critério de aceitação e Frequência conforme formulários do cliente

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari

Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado