

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: BIOMECÂNICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
Endereço: Rua Luiz Pengo, N° 145 - 1° Distrito Industrial - Jaú - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico
N° de Ativo: GAB-720A-1
N° de Série: Não consta
Modelo: Passa / Não Passa

Local da Calibração: Metrologia Dimensional

Marca: Kingtools

Especificação da Rosca: 3/16" x 24 BSW (Classe Média)

2 - DATAS:

Recebimento: 17/10/2025

Calibração: 30/10/2025

Emissão: 30/10/2025

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°

MPC-0089

Revisão: 10

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

N° Padrão	Descrição do Equipamento	N° do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0224, Metrus, CAL 0442	02/2026
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	32510-24-DI/SP, Calibratec, CAL 0114	11/2026
MTR-0499	Máquina de Medição Linear	D04408/25, Feinmess, CAL 0133	05/2027
MTR-0491	Jogo de Arame	D0178029-0925, Metrus, CAL 0442	09/2027
MTR-0061	Escala Angular	0773/24, Certi, CAL 0034	03/2027

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

LADO PASSA					
Diâmetro do Flanco (0°)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura A	4,0894	-0,0050	2,00	Infinito	0,0020
Altura B	4,0897	-0,0047	2,00	Infinito	0,0020


Diâmetro do Flanco (90°)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura A	4,0904	-0,0040	2,00	Infinito	0,0020
Altura B	4,0908	-0,0036	2,00	Infinito	0,0020

Passo (Altura Central)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
0°	1,0597	0,0014	2,00	Infinito	0,0020
90°	1,0589	0,0006	2,00	Infinito	0,0020

Semi Ângulo (Altura Central 0°)					
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	27° 31'	1	2,00	Infinito	4
LE	27° 32'	2	2,00	Infinito	4

Semi Ângulo (Altura Central 90°)					
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	27° 31'	1	2,00	Infinito	4
LE	27° 32'	2	2,00	Infinito	4


Especificações conforme a Norma BS 919		
Diâmetro Nominal	4,0944	mm
Diâmetro Mínimo	4,0894	mm
Diâmetro Máximo	4,0994	mm
Desgaste	--	mm
Passo	1,0583	mm
Semi Ângulo	27° 30'	± 21'

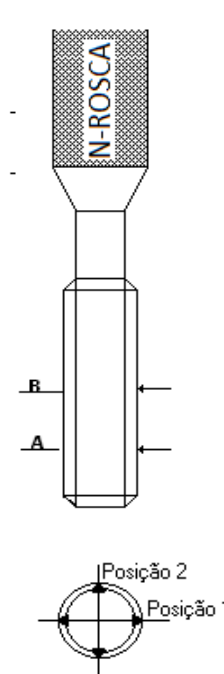

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

LADO NÃO PASSA					
Diâmetro do Flanco (0°)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura A	4,1740	-0,0042	2,00	Infinito	0,0020
Diâmetro do Flanco (90°)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura A	4,1744	-0,0038	2,00	Infinito	0,0020
Passo (Altura Central)					
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
0°	1,0605	0,0022	2,00	Infinito	0,0020
90°	1,0596	0,0013	2,00	Infinito	0,0020
Semi Ângulo (Altura Central 0°)					
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	27° 32'	2	2,00	Infinito	4
LE	27° 31'	1	2,00	Infinito	4
Semi Ângulo (Altura Central 90°)					
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	27° 32'	2	2,00	Infinito	4
LE	27° 31'	1	2,00	Infinito	4
Lado Passa			Lado Não Passa		
Critério de Aceitação			Critério de Aceitação		
0,0100 mm			0,0100 mm		
Erro + Im (máximos)			Erro + Im (máximos)		
0,0070 mm			0,0062 mm		
Status			Status		
Aprovado			Aprovado		

Especificações conforme a Norma BS 919		
Diâmetro Nominal	4,1782	mm
Diâmetro Mínimo	4,1732	mm
Diâmetro Máximo	4,1832	mm
Desgaste	--	mm
Passo	1,0583	mm
Semi Ângulo	27° 30'	± 21'

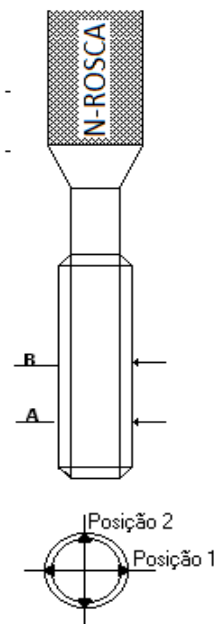

7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada parâmetro medido, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Nominal de cada parâmetro
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari



Luis Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-CTRC - REV.15 - DATA 28/05/2025